




WOUTERSE ORTHODONTIC APPLIANCES LABORATORY

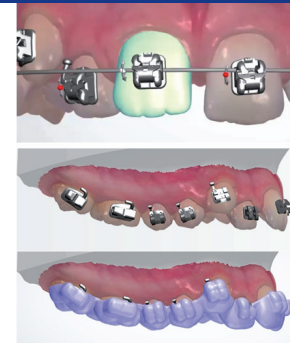

Clear-Ortho

Tel. 0418 651854

email: balie@WouterseOrthoLab.com

3D Clear Aligner

3D digital appliance design

3D digital STL Printing

3D Indirect-Bonding

Opdracht

i.o.v. heer / mevr.patiënt
geb. datumafdrukdatum.....patiënt nr.

DOCUMENTATION

Werkmodellen boven / onder / **3D** digitale modellen
Studiemodellen gezeept / ongezeept / gro / utr. / amerik. / **3D** digitale modellen

Uitneembaar apparaat

Boven regulatie / expansie / kleur
Onder beetverhoging% in het front / zijdelings
Banden / brackets blijven ja nee *

Functioneel

1/2 Open Activator _____ Open Activator _____ Bionator _____

Twin Block Vrijslipen ja / nee *
Van Beek Vrijslipen ja / nee *
T-appliances Face bow / High-pull ja / nee *

LRM activator

Eva fixed appl. activator

kleur boven..... kleur onder..... (vraag kleuring)

Intermaxillaire correctie veren, in combinatie met;

.....*

SVP. omcirkelen wat van toepassing is*

Opmerking:.....

.....

.....

RETOURDATUM;

FIXED APPLIANCES SYSTEMS

Indirect bonding opmerking aangeven boven / onder

Bands 76 / 67 for 1hg / tpa / gh / single / 7654 / 4567. / lipbumber / libo / single

Rapid palatal expander hyrax acrylic / 2 of 4x bands

Face-bow / quad helix / tpa / lipbumber / lingual arch

Hanks **HERBST** appliance met / zonder molaarbanden

FINISHING APPLIANCES

Modify hawley retainer passive labial arch

Cuspid to cuspid indirect bonding retainer

ClearOrtho Retainer

Wi-vision-er Positioner

ClearOrtho Aligner*

aangeven svp.....*


DIVERSEN

Registratie CHIP (draagtijd) sensor

Rep. / aanpassing.....

etc

In tandboog:
opmerkingen graag aangeven

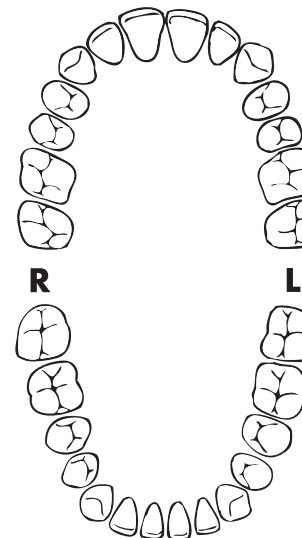

ORDER	240001
Client nr.	

Portvrije Retourzending: (vraag om retour emblemen)
UPS gratis nummer; 020-50 40 500

VOOR GIPS ADMINISTRATIE:

ORDER **240001**

Gereed:

Werkmodel: boven / onder

Studiemodel: Gro / Utr. / Amerik.
gezeept / ongezeept



VOOR GIPS ADMINISTRATIE:

ORDER **240001**

Gereed:

Werkmodel: boven / onder


Studiemodel: Gro / Utr. / Amerik.
gezeept / ongezeept





WOUTERSE ORTHODONTIC APPLIANCES

LABORATORY

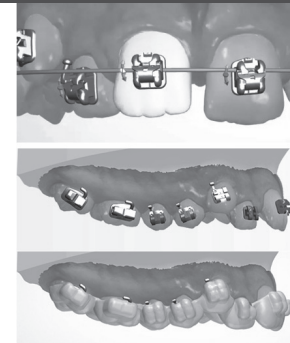

Clear-Ortho

Tel. 0418 651854

email: balie@WouterseOrthoLab.com

3D Clear Aligner

3D digital appliance design

3D digital STL Printing

3D Indirect-Bonding

Opdracht

i.o.v. heer / mevr.patiënt

geb. datumafdrukdatum.....patiënt nr.

DOCUMENTATION

Werkmodellen boven / onder / **3D** digitale modellen

Studiemodellen gezeept / ongezeept / gro / utr. / amerik. / **3D** digitale modellen

Uitneembaar apparaat

Boven regulatie / expansie / kleur

Onder beetverhoging% in het front / zijdelings

Banden / brackets blijven ja nee *

Functioneel

1/2 Open Activator Open Activator Bionator

Twin Block Vrijslipen ja / nee *

Van Beek Vrijslipen ja / nee *

T-appliances Face bow / High-pull ja / nee *

LRM activator

Eva fixed appl. activator

kleur boven..... kleur onder..... (vraag kleurenring)

Intermaxillaire correctie veren, in combinatie met;

.....*

SVP. omcirkelen wat van toepassing is*

Opmerking:.....

.....

.....

RETOURDATUM; Portvrije Retourzending: (vraag om retour emblemen)

UPS gratis nummer; 020-50 40 500

FIXED APPLIANCES SYSTEMS

Indirect bonding opmerking aangeven boven onder

Bands 76 / 67 for 1hg / tpa / gh / single / 7654 / 14567 / lipbumber / libo / single

Rapid palatal expander hyrax acrylic / 2 of 4x bands

Face-bow / quad helix / tpa / lipbumper / lingual arch

Hanks **HERBST** appliance met / zonder molaarbanden

FINISHING APPLIANCES

Modify hawley retainer passive labial arch wire acrylic

Cuspid to cuspid indirect bonding retainer (3) 211 12 (3) / 3211 123

ClearOrtho Retainer boven / onder

Wi-vision-er Positioner set-up ja nee *

ClearOrtho Aligner* elementen voor set-up

aangeven svp.....*

DIVERSEN


Registratie CHIP (draagtijd) sensor ja / nee *

Rep. / aanpassing.....

etc

In tandboog:

opmerkingen graag aangeven

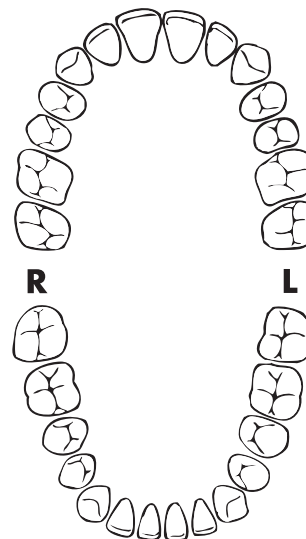

ORDER	240001
Client nr.	


VOOR GIPS ADMINISTRATIE:

ORDER **240001**

Gereed:

Werkmodel: boven / onder

Studiemodel: Gro / Utr. / Amerik.
gezeept / ongezeept



VOOR GIPS ADMINISTRATIE:

ORDER **240001**

Gereed:

Werkmodel: boven / onder

Studiemodel: Gro / Utr. / Amerik.
gezeept / ongezeept

